


いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報24 【カテーテル接続部の破損】

【事例】

UKカテーテル接続部が破損し血液・薬液が漏れた。

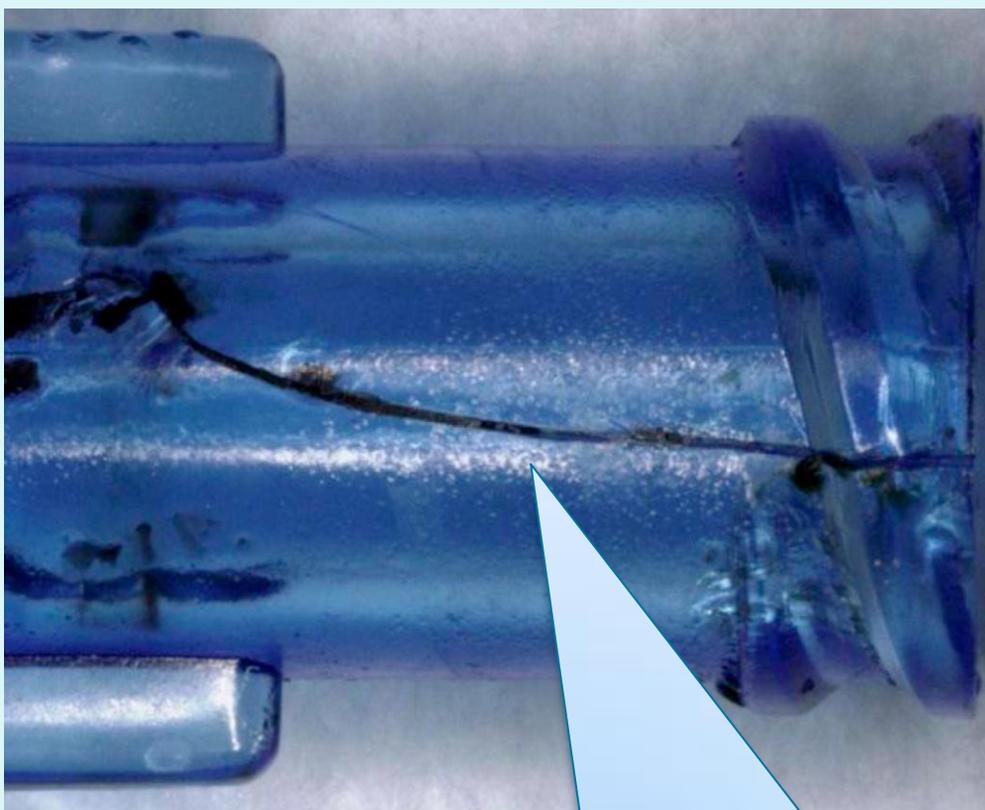

亀裂の原因は？
対策は？

2012.11.27

京大病院医療安全情報24

【鉗子締め付けによる破損】

原因：過度な締め付け・締め直し

対策：①締め付け時や取り外しに鉗子を用いない

②接続部の緩みを定期的にチェック



亀裂を来す
原因となる

しっかり締めよう
として割れてしま
うことがあるんだ
ね。

添付文書より：

「過度な締め付けをしないこと。コネクタが外れなくなる、またはコネクタが破損する可能性がある。

